

DE -Dimethylformamid 10/b (67 18 501) Dräger-Röhrchen®

WARNING


Röhrcheninhalt hat toxische/ätzende Eigenschaften, nicht verschlucken, Haut- oder Augenkontakt ausschließen. Vorsicht beim Öffnen, es können Glassplitter abspringen.

1 Anwendungsbereich/Umgebungsbedingungen

Bestimmung von Diethylether in Luft oder technischen Gasen.

Messbereich	: 10 bis 40 ppm
Hubzahl (n)	: 10
Dauer der Messung	: ca. 3 min
Standardabweichung	: $\pm 20\%$ bis 30%
Farbumschlag	: gelb → grau-blau
Temperatur	: 15°C bis 35°C
Feuchtigkeit:	3 - 12 mg/L (12 mg/L entspr. 70 % r.F bei 20°C)
Luftdruck:	F = 1013/tatsächlicher Luftdruck (hPa)

2 Reaktionsprinzip



3 Voraussetzungen

Die Funktionsweise der Röhrchen und der Dräger-Röhrchen-Pumpen sind aufeinander abgestimmt. Die Verwendung anderer Pumpen kann die ordnungsgemäße Funktion der Röhrchen gefährden.

Gebrauchsanweisung der Pumpe (Dichtetest!) beachten.
Messwert gilt nur für Ort und Zeitpunkt der Messung.

4 Messung durchführen und auswerten

WARNING

Vor der Messung muss Folgendes geprüft werden, sonst ist eine Messung nicht möglich: Röhrchen müssen fest im Schrumpfschlauch sitzen. Nach dem Brechen der Röhrchenspitzen muss der Schrumpfschlauch unbeschädigt sein. Wenn das Röhrchen in die Pumpe eingesetzt wird, muss der Pfeil zur Pumpe zeigen. Alle Spitzen des Röhrchens müssen abgebrochen sein.

1. Durch Schrumpfschlauch verdeckte innere Röhrchenspitzen abbrechen; dazu ein Röhrchenende festhalten und das andere soweit biegen, bis die innere Spitze abbricht. Den Vorgang für die zweite innere Spitze wiederholen.
2. Beide äußeren Spitzen des Röhrchens im Röhrchen-Öffner abbrechen.
3. Röhrchenkombination dicht in die Pumpe einsetzen. Pfeil zeigt zur Pumpe.
4. Luft- oder Gasprobe durch das Röhrchen saugen.
5. Gesamte Länge der Verfärbung ablesen.
6. Wert mit dem Faktor F für die Luftdruckkorrektur multiplizieren.
7. Pumpe nach Gebrauch mit Luft spülen.
1 ppm Dimethylformamid = 3,03 mg Dimethylformamid / m³
1 mg Dimethylformamid / m³ = 0,33 ppm Dimethylformamid (bei 20°C , 1013 hPa)

5 Querempfindlichkeiten

Anderre basische Stoffe wie z.B. Ammoniak, organische Amine und Hydrazin werden ebenfalls angezeigt, jedoch mit unterschiedlicher Empfindlichkeit.

6 Weitere Informationen

Auf der Verpackungsbanderole befinden sich Bestellnummer, Verbrauchsdatum, Lagertemperatur und Seriennummer. Bei Rückfragen die Seriennummer angeben.

HINWEIS

Nach Ablauf des Verbrauchsdatums Röhrchen nicht mehr verwenden. Röhrchen gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen oder in der Verpackung zurückgeben. Sicher vor Unbefugten lagern.

EN - Dimethyl formamide 10/b (67 18 501) Dräger Tube®

WARNING


The tube content is toxic. Do not swallow. Avoid skin or eye contact. Caution when opening the tube, glass splinters may come off.

1 Application Range / Ambient Conditions

Determination of diethyl ether in air or technical gases.

Measuring Range	: 10 to 40 ppm
Number of Strokes (n)	: 10
Time of Measurement	: approx. 3 min
Standard Deviation	: $\pm 20\%$ to 30%
Colour Change	: yellow → grey-blue
Temperature	: 15°C to 35°C
Humidity: 3 - 12 mg/L (12 mg/L corresp. 70 % r.F bei 20°C)	
Atmospheric pressure : F	= 1013/actual atmospheric pressure (hPa)

2 Principle of Reaction



3 Requirements

The Dräger tubes and the Dräger tube pumps work in a coordinated manner. Proper functioning of the tubes may be impaired when used with other pumps.

Observe the Instructions for Use of the pump (Leak test!).
The measured value is applicable only to the place and date of measurement.

4 Measurement and Evaluation

WARNING

The following must be verified prior to the measurement or is not possible to use the device: Tube must be firmly seated in shrink hose. The shrink hose must be undamaged after breaking the tube tip. When the tube is inserted into the pump, the arrow must point to the pump. All tips of the tube must be broken off.

1. Break of the internal tips of the tube which are concealed by the shrunk-on tubing; to do so, hold the tube at one end and bend the other until the internal tip breaks off. Repeat this procedure for the second internal tip.
2. Break both outer tips of the tube in the tube opener.
3. Insert the combined tube tightly in the pump. Arrow points towards the pump.
4. Suck air or gas sample through the tube.
5. Read the entire length of the discoloration.
6. Multiply the value by factor F for correction of the atmospheric pressure.
7. Flush the pump with air after operation.
1 ppm dimethyl formamide = 3,03 mg dimethyl formamide/m³
1 mg dimethyl formamide/m³ = 0,33 ppm dimethyl formamide (at $20^\circ\text{C}/68^\circ\text{F}$, 1013 hPa /14.692 psi)

5 Cross Sensitivities

Other basic substances, e.g. ammonia, organics amines and hydrazine are also indicated, however, with differing sensitivity.

6 Additional Information

The package strip indicates order number, shelf life, storing temperature and serial number. State serial number for inquiries.

NOTICE

Do not use tubes after the shelf life has expired. Dispose of tubes in accordance with the local directives or return in packaging. Keep out of reach of unauthorized persons.

FR - Diméthylformamide 10/b (67 18 501) Dräger Tube réactif®

AVERTISSEMENT


Le contenu du tube réactif a des propriétés toxiques/irritantes. Ne pas avaler et éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Attention, lors de l'ouverture, des éclats de verre peuvent être projetés !

1 Domaine d'utilisation / Conditions ambiantes

Détermination du diéthyléther dans l'air ou dans des gaz techniques.

Plage de mesure	: 10 à 40 ppm
Nombre de courses (n)	: 10
Durée de la mesure	: env. 3 min
Ecart type	: $\pm 20\%$ à 30%
Changement de couleur :	jaune → gris-bleu
Température	: 15°C à 35°C
Humidité : 3 - 12 mg/L (12 mg/L correspond à 70 % d'humidité relative à 20°C)	
Pression atmosphérique : F	= 1013/pression atmosphérique réelle (hPa)

2 Principe réactionnel



3 Conditions

Le mode de fonctionnement des tubes et celui des pompes pour tubes Dräger sont adaptés l'un à l'autre. L'utilisation d'autres pompes peut altérer le fonctionnement correct des tubes réactifs.

Respecter le mode d'emploi de la pompe (test de densité !).
La valeur de mesure n'est valable que pour le lieu et le moment de la mesure.

4 Analyse et évaluation du résultat

AVERTISSEMENT

Avant la mesure, le point suivant doit être contrôlé, sinon, une mesure est impossible : les tubes réactifs doivent être enfichés à fond dans la gaine thermorétractable. Après avoir cassé les pointes du tube réactif, la gaine thermorétractable ne doit pas être endommagée. Lorsque le tube réactif est inséré dans la pompe, la flèche doit être tournée vers la pompe. Toutes les pointes du tube réactif doivent être cassées.

1. Casser les pointes intérieures des tubes réactifs cachées par le tuyau rétractable ; pour cela, maintenir une extrémité du tube et plier l'autre extrémité jusqu'à ce que la pointe intérieure se casse. Renouveler le processus pour la deuxième pointe intérieure.
2. Casser les deux pointes du tube réactif dans le dispositif d'ouverture des tubes.
3. Insérer à fond la combinaison des tubes dans la pompe. La flèche est tournée vers la pompe.
4. Aspirer l'échantillon d'air ou de gaz à travers le tube réactif.
5. Reléver la longueur complète de la coloration.
6. Multiplier la valeur avec le facteur F pour la correction de la pression atmosphérique.
7. Rincer la pompe avec de l'air après utilisation.
1 ppm diméthylformamide = 3,03 mg diméthylformamide/m³
1 mg diméthylformamide/m³ = 0,33 ppm diméthylformamide (à 20°C , 1013 hPa)

5 Sensibilités transversales

Les autres substances basiques comme par ex. l'ammoniac, les amines organiques et l'hydrazine sont aussi indiquées mais avec des sensibilités différentes.

6 Informations complémentaires

Sur la banderole d'emballage figurent : code de commande, date de péremption, température de stockage et no de série. Indiquer ce dernier en cas de réclamations.

NOTICE

Après dépassement de la date de péremption, ne plus utiliser les tubes réactifs. Eliminer les tubes réactifs selon les directives locales ou les restituer dans leur emballage. A stocker hors de portée des personnes non autorisées.

ES - Demetylformamida 10/b (67 18 501) Tubo de control Dräger®

ADVERTENCIA

El contenido del tubo de control tiene propiedades tóxicas/ corrosivas. No ingerir. Evitar el contacto con la piel o los ojos. Tenga cuidado al abrir, pueden saltar pequeños trozos de cristal.

1 Campo de aplicación/condiciones ambientales

Determinación de dietilether en aire o gases industriales.

Ámbito de medición : de 10 a 40 ppm

Número de carreras del : 10

émbolo (n)

Duración de la medición: aprox. 3 min

Desviación típica : de $\pm 20\%$ a 30%

Viraje : amarillo → gris-azul

Temperatura : de 15°C a 35°C

Humedad : 3 - 12 mg/L (12 mg/L correspond a 70 % HR a 20°C)

Presión atmosférica: F = 1013/presión atmosférica real (hPa)

2 Principio de reacción



$\text{NH}_3 + \text{indicador de pH} \rightarrow \text{producto de reacción gris-azul}$

3 Condiciones

Los modos de funcionamiento de los tubos y las bombas para tubos Dräger están coordinados entre sí. La utilización de otras bombas puede poner en riesgo el funcionamiento correcto de los tubos de control. **Tener en cuenta el manual de instrucciones de la bomba (¡Prueba de estanqueidad!).** El valor medido es válido únicamente para el sitio y la hora en que se efectúa la medición.

4 Realización y evaluación de la medición

ADVERTENCIA

Para poder realizar una medición, antes se debe comprobar lo siguiente: Los tubos se deben fijar en el tubo termo-encogible. Tras la ruptura de las puntas, el tubo termo-encogible debe permanecer intacto. Una vez colocado el tubo en la bomba, la flecha debe apuntar hacia la bomba. Todas las puntas del tubo tienen que estar rotas.

1. Romper las puntas interiores ocultas en el tubo retráctil; para ello sujetar un extremo del tubo y doblar el otro hasta que rompa la punta interior. Repetir el proceso con la segunda punta interior.
2. Romper ambas puntas exteriores del tubo en el abridor de tubos.
3. Colocar la combinación de tubos ajustada en la bomba. La flecha apunta hacia la bomba.
4. Aspirar la muestra de aire o gas a través del tubo.
5. Leer toda la longitud de la decoloración.
6. Multiplicar el valor por el factor F para la corrección de la presión atmosférica.
7. Purgar la bomba con aire tras el uso.
1 ppm dimetilformamida = 3,03 mg dimetilformamida / m³
1 mg dimetilformamida / m³ = 0,33 ppm dimetilformamida (a 20°C , 1013 hPa)

5 Sensibilidad cruzada

Otras sustancias básicas como p. ej. amoníaco, aminas orgánicas e hidracina también se muestran pero con diferente sensibilidad.


6 Información adicional

En la etiqueta del estuche están indicados: referencia, fecha de caducidad, temperatura de almacenamiento y nº de fabricación. En caso de consultas, indiquenos el nº de fabricación.

NOTA

Una vez sobrepasada la fecha de utilización, no utilizar más el tubo de control. Desechar los tubos de control según las directivas locales o devolverlos en su embalaje. Almacenar fuera del alcance de personas no autorizadas.

Dräger

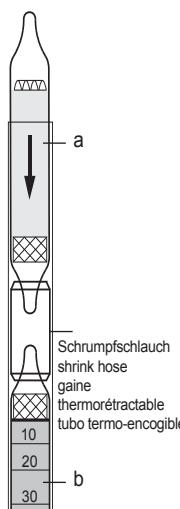

a = weiße Vorschicht, white prelayer,
couché préalable blanche, nivel previo blanco
b = gelbe Anzeigeschicht, yellow indicating layer, couche d'indication jaune, nivel de indicación amarillo

NL - Dimethylformamide 10/b (67 18 501)
Dräger Tube®

WAARSCHUWING

De inhoud van het buisje is toxicus en etsend, niet inslikken, contact met de huid en ogen vermijden. Voorzichtig bij het openen, er kunnen glassplinters losraken.

1 Toepassingsgebied/omgevingsfactoren

Vaststellen van diethylether in lucht of technische gassen.

Meetbereik : 10 tot 40 ppm

Aantal pompslagen (n) : 10

Duur van de meting : ca. 3 min

Standaardafwijking : ± 20 % tot 30 %

Kleuromslag : geel → grijs-blauw

Temperatuur : 15 °C tot 35 °C

Vochtigheid: 3 - 12 mg/L (12 mg/L gelijk aan 70 % r.l. bij 20 °C)

Luchtdruk: F = 1013/daadwerk. luchtdruk (hPa)

2 Reactieprincipe

Dimethylformamide + NaOH → NH₃

NH₃ + pH-indicator → grijs-blauw reactieproduct

3 Voorwaarden

De werkingswijze van de buisjes en van de Dräger buisjespomp zijn op elkaar afgestemd. Het gebruik van andere pompen kan de correcte werking van de buisjes in gevaar brengen.

Gebruiksaanwijzing van de pomp (lektest) lezen.

De gemeten waarde geldt slechts voor plaats en tijdstip van de meting.

4 Uitvoering van de meting en beoordeling van het meetresultaat

WAARSCHUWING

Voorafgaand aan de meting moet het volgende worden gecontroleerd, anders is een meting niet mogelijk: Buisjes moeten vast in de krimpkoous zitten. Na het breken van de buisjespunt moet de krimpkoous onbeschadigd zijn. Wanneer het buisje in de pomp wordt geplaatst, moet de pijl naar de pomp wijzen. Alle punten van het buisje moeten afgebroken zijn.

1. Door krimpslang afdekte interne buispunten afbreken; daartoe een buisuiteinde vasthouden en het andere zover buigen, tot de interne punt afbreekt. Herhaal dit proces voor de tweede interne punt.

2. Beide buitenste punten van het buisje in de buisjesopener afbreken.

3. Buisje afsluitend in de pomp plaatsten. Pijl wijst naar de pomp.

4. Lucht- of gasmonster door het buisje zuigen.

5. Gehalte lengte van de verkleuring aflezen

6. Waarde met de factor F voor de luchtdrukcorrectie vermenigvuldigen.

7. pomp na gebruik met lucht spoelen:

1 ppm dimethylformamide = 3,03 mg dimethylformamide / m³
1 mg dimethylformamide / m³ = 0,33 ppm dimethylformamide (bij 20 °C, 1013 hPa)

5 Specificiteit (kruisgevoeligheid)

Andere basische stoffen zoals bijv. ammoniak, organische amine en hydrazine worden ook aangevoerd, maar met verschillende gevoeligheid.

6 Verdere informatie

Op de verpakkingsbanderol worden het bestelnummer, de uiterste gebruiksdatum, de bewaar temperatuur en het serienummer aangegeven. Bij specifieke vragen/klachten dient u het serienummer op te geven.

AANWIJZING

Na het verlopen van de gebruiksdatum buisjes niet meer gebruiken. Buisjes conform de plaatselijke richtlijnen afvoeren of in de verpakking retourneren. Veilig opslaan ter voorkoming van gebruik door onbevoegden.

DA - Dimethylformamid 10/b (67 18 501) DrägerTube®

ADVARSEL

Rørets indhold har toksiske/ætsende egenskaber, må ikke indtages, undgå hud- eller øjenkontakt. Vær forsigtig ved åbning, der kan springe glasssplinter af.

1 Anvendelsesområde/omgivelsesbetegnelser

Måling af dimethylæter i luft eller tekniske gasser.

Måleområde : 10 til 40 ppm

Slægtal (n) : 10

Målingens varighed : ca. 3 min

Standardafvigelse : ± 20 % til 30 %

Farveændring : gul → grå-blå

Temperatur : 15 °C til 35 °C

Fugtighed: 3 - 12 mg/L (12 mg/L svarende til 70 % r.f. ved 20 °C)
Lufttryk: F = 1013/faktisk lufttryk (hPa)

2 Reaktionsprincip

Dimethylformamid + NaOH → NH₃

NH₃ + pH-indikator → grå-blåt reaktionsprodukt

3 Forudsætninger

Rørenes og Dräger-rør-pumpernes funktion er afstemt efter hinanden. Anvendelse af andre pumper kan bringe rørenes korrekte funktion i fare.

Se brugsanvisningen til pumpen (tæthedsprøve).

Den aflestte værdi er en øjeblikskoncentration.

4 Måling og analyse

ADVARSEL

Inden målingen skal man kontrollere følgende, ellers er en måling ikke mulig: Røret skal sidde fast i krimpeslangen. Når rørspidser er brækket af, skal krimpeslangen være ubeskadiget. Når røret indsættes i pumpen, skal pilen pege hen mod pumpen. Alle rørets spidser skal være brækket af.

1. De indre rørsidser, som er dækket til af en skrimpeslange, knækkes af; her til tager man fat i den ene ende af røret, og den anden ende bøjes indtil den indre spids knækker. Processen gentages for den anden indre spids.
2. Bræt begge ydre spidser i rør-abrenner af.
3. Rørkombinationen sættes tæt ind i pumpen. Pilens pege mod pumpen.
4. Luft- eller gasprøven suges igennem røret.
5. Aflæs hele farveændringens længde.
6. Værdien ganges med faktor F for lufttryksjustering.
7. Skyd pumpen med luft efter brug.

1 ppm dimethylformamid = 3,03 mg dimethylformamid / m³
1 mg dimethylformamide / m³ = 0,33 ppm dimethylformamide (ved 20 °C, 1013 hPa)

5 Interfererende stoffer

Andre basiske stoffer som f.eks. ammoniak, organiske aminer og hydrazin vises ligeført, men med forskellig følsomhed.

6 Øvrige informationer

Bestillingsnummer, holdbarhedsdato, opbevaringstemperatur og serienummer fremgår af banderolen på emballagen. Angiv venligst serienummer ved henvendelse.

BEMÆRK

Røret må ikke anvendes efter udløb af anvendelsesdatoen. Røret skal bortsættes i henhold til nationale forskrifter eller returneres i emballagen. Skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

IT - Dimethylformamide 10/b (67 18 501) Dräger Tube®

AVVERTENZA

Il contenuto delle fiale ha proprietà tossiche e corrosive, non inghiottire, evitare qualsiasi contatto con la pelle e gli occhi. Fare attenzione nell'aprire le fiale, potrebbero saltare dei frammenti di vetro.

1 Campi d'impiego/condizioni ambientali

Determinazione del dietiltere nell'aria o nei gas tecnici

Campo di misurazione : 10 - 40 ppm

Numeri pompare (n) : 10

Durata della misurazione : ca. 3 min

Variazione standard : ± 20 % - 30 %

Viraggio di colore : giallo → grigio-azzurro

Temperatura : 15 °C - 35 °C

Umidità: 3 - 12 mg/L (12 mg/L corrisp. a 70 % UR a 20 °C)

Pressione dell'aria: F = 1013/pressione dell'aria effettiva (hPa)

2 Principio di reazione

Dimethylformamide + NaOH → NH₃

NH₃ + indicatore pH → prodotto di reazione grigio-azzurro

3 Requisiti

Il modo di funzionamento delle fiale e delle pompe per fiale Dräger ne consente l'utilizzo congiunto. L'impiego di altri tipi di pompe può compromettere il corretto funzionamento delle fiale. **Osservare le istruzioni d'uso della pompa (test di tenuta).** Il valore di misurazione vale solo per il luogo ed il momento in cui è svolta la misurazione.

4 Esecuzione e valutazione della misurazione

AVVERTENZA

Prima di effettuare una misurazione, occorre verificare quanto indicato di seguito; altrimenti non è possibile eseguire la misurazione. Le fiale dovranno essere ben fissate nella guaina termorestringente. Dopo aver rotto le punte delle fiale, la guaina termorestringente non dovrà risultare danneggiata. Quando si inserisce la fiale nella pompa, la freccia deve puntare verso quest'ultima. Si devono rompere entrambe le punte della fiale.

1. Rompere le punte interne della fiale nascoste dalla guaina termorestringibile; per fare ciò, bisogna tenere ferma una punta della fiale piegando l'altra, finché non si rompe la punta interna. Procedere nello stesso modo per rompere la seconda punta interna.
2. Rompere le due punte esterne della fiale nell'aprifiale.
3. Fissare bene nella pompa l'insieme di fiale. La freccia è rivolta verso la pompa.
4. Aspirare il campione di aria o gas attraverso la fiale.
5. Rilevare la lunghezza totale del tratto del viraggio.
6. Moltiplicare il valore per il fattore F per la correzione della pressione dell'aria.
7. Spurgare con aria la pompa dopo averla utilizzata.

1 ppm dimethylformamide = 3,03 mg dimethylformamide / m³
1 mg dimethylformamide / m³ = 0,33 ppm dimethylformamide (a 20 °C, 1013 hPa)

5 Effetti di sensibilità trasversale

Altre sostanze basiche come, per es., l'ammoniaca, le ammine organiche e l'idrazina vengono altrettanto indicate, ma con una sensibilità differente.

6 Informazioni addizionali

Sulla fascetta della confezione sono riportati numero d'ordinazione, data di scadenza, temperatura di conservazione e numero di serie. In caso di consultazioni indicare il numero di serie.

i NOTA

Dopo la data di scadenza non utilizzare più la fiale. Smaltire le fiale attenendosi alle normative vigenti a livello locale oppure rispedire indietro nella loro confezione. Conservare le fiale al sicuro fuori dalla portata di persone non autorizzate.

RU - Диметилформамид 10/b (67 18 501) Dräger Tube®

ОСТОРОЖНО

Содержимое трубки токсично/агрессивно. Не принимайте внутрь, исклюите контакт с кожей и глазами. Открывайте осторожно - возможно образование осколков стекла.

1 Область использования/условия окружающей среды

Определение содержания диметилформамида в воздухе или технических газах.

Диапазон измерений : 10 - 40 ppm

Число качков (n) : 10

Время измерения : прибл. 3 мин.

Стандартное отклонение : ± 20 % - 30 %

Изменение цвета : желтый → серо-синий

Температура : 15 °C ... 35 °C

Влажность: 3 - 12 mg/l (12 mg/l соотв. 70 % отн. влажн. при 20 °C)

Поправочный коэффициент : F = 1013/фактическое давление воздуха (Па)

2 Принцип реакции

Dimethylformamide + NaOH → NH₃

NH₃ + индикатор pH → серо-синий продукт реакции

3 Условия проведения анализа

Принципы действия индикаторных трубок и насосов Dräger для трубок взаимно согласованы. Использование других насосов может повредить надлежащему функционированию индикаторных трубок. Соблюдайте инструкцию по эксплуатации насоса (испытания на герметичность!).

Полученные результаты действительны только в месте и в момент измерения.

4 Проведение измерений и оценка результатов

ОСТОРОЖНО

Перед измерением необходимо выполнить следующую проверку, иначе измерение невозможно: Трубки должны быть плотно установлены в обжимной трубке. После вскрытия концов трубок обжимная трубка должна оставаться неповрежденной. При установке трубки в насос стрелка должна указывать на насос. Должны быть вскрыты оба конца трубки.

1. Отломайте запаянные внутренние концы трубок под обжимной трубкой; для этого возьмите трубку за один конец и отогните ее, пока не сломается внутренний конец. Аналогично отломайте внутренний конец второй трубки.

2. Отломайте оба внешних конца трубки с помощью открывателя.

3. Плотно вставьте комбинированную трубку в насос. Стрелка должна указывать на насос.

4. Прокачивайте пробу воздуха или газа через трубку.

5. Считайте всю длину окраски.

6. Умножьте значение на коэффициент F для поправки на атмосферное давление.

7. После измерения прокачайте насос чистым воздухом.
1 ppm диметилформамида = 3,03 mg диметилформамида/m³
1 mg диметилформамида/m³ = 0,33 ppm диметилформамида (при 20 °C, 1013 гПа)

5 Перекрестная чувствительность

Также измеряются прочие щелочные газы, например, аммиак, органические амины и гидразин, но с отличающейся чувствительностью.


6 Дополнительная информация

На бандероль упаковки нанесены номер заказа, срок годности, температура хранения и серийный номер. При запросах указывайте серийный номер.

i УКАЗАНИЕ

После истечения срока годности трубку больше не использовать. Утилизацию индикаторных трубок производить в соответствии с местными нормативными документами или возвращать их в упаковке. Хранить в месте, недоступном для посторонних.

Dräger

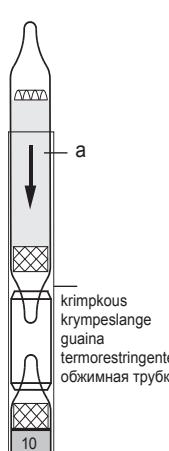

a = witte voorlaag,
hvid forlag,
strato iniziale bianco,
белый предварительный слой

b = gele indicatielaag,
gult pávisningslag,
strato indicatore giallo,
желтый индикаторный слой