

Gebräuchsanweisung  
Dräger-Röhrchen®  
**Phosphorwasserstoff 0,01/a** 81 01 611  
DEUTSCH

**ACHTUNG!**  
Prüfröhreninhalt hat toxische/ätzende Eigenschaften, nicht verschlucken, Haut- oder Augenkontakt ausschließen. Vorsicht beim Öffnen, es können Glassplitter abspringen. Verletzungsgefahr durch scharfkantige Spitzen. Prüfröhren als gefährlichen Abfall entsorgen oder in der Verpackung zurückgeben. Sicher vor Unbefugten lagern.

Anwendungsbereich

Bestimmung von Phosphorwasserstoff in Luft.

Messbereich : 0,01 bis 0,3 ppm 0,1 bis 1,0 ppm

Hubzahl (n) : 10 3

Dauer der Messung : ca. 8 min ca. 2,5 min

Standardabweichung : ± 10 - 15 %

Farbumschlag : gelb → rot


Umgebungsbedingungen

Temperatur : 2 °C bis 40 °C

Feuchtigkeit : < 20 mg/L (entspr. 100 % r.F bei 23 °C)

Luftdruck : F = 1013/tatsächlicher Luftdruck (hPa)

Reaktionsprinzip



HCl + pH-Indikator

→ rotes Reaktionsprinzip

Voraussetzungen

Die Funktionsweise der Dräger-Röhrchen und der Dräger-Pumpen accuro, accuro 2000 und Quantimeter 1000 sind aufeinander abgestimmt. Eine ordnungsgemäße Funktion bei Verwendung der Dräger-Röhrchen im Zusammenhang mit anderen Pumpen kann nicht garantiert werden.

Gebräuchsanweisung der Pumpe (Dichtetest!) beachten.

Messwert gilt nur für Ort und Zeitpunkt der Messung.

Messung durchführen und auswerten

- Beide Spitzen des Röhrchens abbrechen.
- Röhrchen dicht in die Pumpe einsetzen. Pfeil zeigt zur Pumpe.
- Luft- oder Gasprobe durch das Röhrchen saugen.
- Gesamt Länge der Verfärbung ablesen.
- Wert mit dem Faktor F für die Luftdruckkorrektur multiplizieren.
- Pumpe nach Gebrauch mit Luft spülen.

$$1 \text{ ppm PH}_3 = 1,42 \text{ mg PH}_3/\text{m}^3$$

$$1 \text{ mg PH}_3/\text{m}^3 = 0,71 \text{ ppm PH}_3 (20^\circ\text{C}, 1013 \text{ hPa})$$

Querempfindlichkeiten

- Maximal 6 ppm Schwefelkohlenstoff oder 15 ppm Chlorwasserstoff stören die Anzeige nicht. Höhere Konzentrationen ergeben Plus-Fehler.
- Ammoniak (>100 ppm) ergeben Minus-Fehler.
- Schwefelwasserstoff und Arsenwasserstoff werden mit unterschiedlicher Empfindlichkeit angezeigt.
- 30 ppm Blausäure stören bei der 3-Hub-Messung nicht. Bei der 10-Hub-Messung treten Minus-Fehler bis 50 % auf.

Weitere Informationen

Auf der Verpackungsbanderole befinden sich Bestellnummer, Verbrauchsdatum, Lagertemperatur und Seriennummer. Bei Rückfragen die Seriennummer angeben.

Instructions for Use

**Phosphine 0,01/a**

Dräger Tube™

81 01 611  
ENGLISH



**CAUTION!**

The tube content is toxic. Do not swallow. Prevent skin or eye contact. Caution when opening the tube, glass splinter may come off. Danger of injury due to sharp edges. Dispose of tubes as hazardous waste or return in packaging. Keep out of reach of unauthorized persons.

**Application Range**

Determination of phosphine in air.

Measuring Range : 0,01 to 0,3 ppm 0,1 to 1,0 ppm

Number of Strokes (n) : 10 3

Time of Measurement : approx. 8 min approx. 2,5 min

Standard Deviation : ± 10 - 15 %

Colour Change : yellow → red


**Ambient Conditions**

Temperature : 2 °C to 40 °C

Humidity : < 20 mg/L (corresp. 100 % r.H at 23 °C)

Atmospheric pressure: F = 1013/actual atmospheric pressure (hPa)

**Principle of Reaction**



HCl + pH-Indicator → red reaction product

**Requirements**

The Dräger tubes' principle of operation and that of the Dräger-pumps (accuro, accuro 2000 and Quantimeter 1000) are matched. Proper function of Dräger tubes with pumps of other make cannot be guaranteed.

Observe the Instructions for Use of the pump (Leak test!).

The measured value is applicable only to the place and date of measurement.

**Measurement and Evaluation**

- Break off both tips of the tube in the tube opener.
- Insert the tube tightly in the pump. Arrow points towards the pump.
- Suck air or gas sample through the tube.
- Read the entire length of the discolouration.
- Multiply the value by factor F for correction of the atmospheric pressure.
- Flush the pump with air after operation.

$$1 \text{ ppm PH}_3 = 1,42 \text{ mg PH}_3/\text{m}^3$$

$$1 \text{ mg PH}_3/\text{m}^3 = 0,71 \text{ ppm PH}_3 (at 20^\circ\text{C}, 1013 \text{ hPa})$$

**Cross Sensitivities**

- A maximum of 6 ppm sulphur dioxide or 15 ppm hydrogen chloride have no influence on the reading. Higher concentrations result in plus errors.
- Ammonia (>100 ppm) result in minus errors.
- Hydrogen sulphide and Arsine are indicated with different sensitivities.
- 30 ppm hydrocyanic acid have no influence on a 3-stroke measurement.
- However, minus errors up to 50 % occur with the 10-stroke measurement.

**Additional Information**

The package strip indicates order number, shelf life, storage temperature and serial number. State the serial number for inquiries.

Mode d'emploi

**Hydrogène phosphore 0,01/a** 81 01 611  
FRANÇAIS

**ATTENTION !**

Le contenu du tube de contrôle a des propriétés toxiques/irritantes. Ne pas avaler et éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Attention à l'ouverture, risque de projection d'éclats de verre. Risque de blessures occasionnées par des pointes coupantes. Mettre au rebut le tube de contrôle avec les déchets dangereux ou le retourner dans son emballage. Stocker dans un endroit sûr à l'écart des personnes non autorisées.

**Domaine d'application**

Détermination de l'hydrogène phosphore dans l'air.

Plage de mesure : 0,01 à 0,3 ppm 0,1 à 1,0 ppm

Nombre de courses (n) : 10 3

Durée de la mesure : env. 8 min env. 2,5 min

Ecart type : ± 10 - 15 %

Changement de couleur : jaune → rouge


**Conditions ambiantes**

Température : 2 °C à 40 °C

Humidité : < 20 mg/L (correspond à 100 % d'humidité relative à 23 °C)

Pression de l'air : F = 1013/pression atmosphérique réelle (hPa)

**Principe réactionnel**



HCl + indicateur pH → principe de réaction rouge

**Conditions**

Les modes de fonctionnement des tubes réactifs Dräger et des pompes Dräger accuro, accuro 2000 et Quantimeter 1000 sont conçus pour être utilisés ensemble. Il n'est pas possible de garantir un bon fonctionnement des tubes réactifs Dräger s'ils sont utilisés avec d'autres pompes.

Respecter le mode d'emploi de la pompe (test de densité !).

La valeur mesurée ne s'applique qu'au lieu et au moment de la mesure.

**Effectuer et analyser la mesure**

- Casser les deux pointes du tube réactif.
- Insérer à fond le tube réactif dans la pompe. La flèche est tournée vers la pompe.
- Aspirer l'échantillon d'air ou de gaz à travers le tube réactif.
- Relever la longueur complète de la coloration.
- Multiplier la valeur avec le facteur F pour la correction de la pression atmosphérique.
- Rincer la pompe avec de l'air après utilisation.

$$1 \text{ ppm PH}_3 = 1,42 \text{ mg PH}_3/\text{m}^3$$

$$1 \text{ mg PH}_3/\text{m}^3 = 0,71 \text{ ppm PH}_3 (20^\circ\text{C}, 1013 \text{ hPa})$$

**Sensibilités croisées**

- Au maximum 6 ppm de dioxyde de soufre ou 15 ppm d'hydrogène chloré ne perturbent pas l'affichage. Des concentrations supérieures donnent des erreurs positives.
- L'ammoniac (>100 ppm) donnent des erreurs négatives.
- L'hydrogène sulfuré et l'hydrogène arsénier sont affichés avec différentes sensibilités.
- 30 ppm d'acide cyanhydrique ne perturbent pas avec une mesure à 3 courses. Avec une mesure à 10 courses, des erreurs négatives jusqu'à 50 % surviennent.

**Informations complémentaires**

Sur la bandelette d'emballage figurent : code de commande, date de péremption, température de stockage et no de série. Pour toute question, indiquer le numéro de série.

Instrucciones de uso

**Fosfamina 0,01/a** 81 01 611  
ESPAÑOL

**ATENCIÓN!**

El contenido del tubo de prueba tiene propiedades tóxicas/corrosivas. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Tenga cuidado al abrir, pueden saltar pequeños trozos de cristal. Peligro de lesiones por puntas afiladas. Desechar el tubo de prueba como residuo peligroso o devolverlo a su envoltorio. Almacenar fuera del alcance de personas no autorizadas.

**Campo de aplicación**

Determinación de fosfamina en aire.

Ámbito de medición : de 0,01 a 0,3 ppm de 0,1 a 1,0 ppm

Número de carreras del : 10 3

ímbolo (n)

Duración de la medición : aprox. 8 min aprox. 2,5 min

Desviación típica : ± 10 - 15 %

Viraje : amarillo → rojo


**Condiciones ambientales**

Temperatura : de 2 °C a 40 °C

Humedad : < 20 mg/l (corresp. 100 % HR a 23 °C)

Presión atmosférica: F = 1013/presión atmosférica real (hPa)

**Principio reactivo**



HCl + indicador pH → producto de reacción rojo

**Condiciones**

El modo de función de los tubos Dräger y de las bombas Dräger accuro, accuro 2000 y Quantimeter 1000 están diseñadas de forma conjunta. No se puede garantizar un funcionamiento correcto al utilizar tubos Dräger con otras bombas.

Tener en cuenta el manual de instrucciones de la bomba (Prueba de estanqueidad).

El valor de medición sólo es válido para el lugar y la hora en que se hizo la medición.

**Realizar y evaluar la medición**

- Romper las dos puntas del tubo.
- Colocar el tubo ajustado en la bomba. La flecha apunta hacia la bomba.
- Aspirar la muestra de aire o gas a través del tubo.
- Leer toda la longitud de la decoloración.
- Multiplicar el valor por el factor F para la corrección de la presión atmosférica.
- Purgar la bomba con aire tras el uso.

$$1 \text{ ppm PH}_3 = 1,42 \text{ mg PH}_3/\text{m}^3$$

$$1 \text{ mg PH}_3/\text{m}^3 = 0,71 \text{ ppm PH}_3 (20^\circ\text{C}, 1013 \text{ hPa})$$

**Sensibilidad cruzada**


- Máximo 6 ppm de dióxido de azufre o 15 ppm de cloruro de hidrógeno no alteran la lectura. Las concentraciones mayores provocan errores positivos.
- El amoniaco (>100 ppm) provoca errores negativos.
- El sulfuro de hidrógeno y la arsenamina se muestran con diferente sensibilidad.
- 30 ppm de ácido cianhídrico no alteran la medición con 3 carreras. En la medición de 10 carreras surgen errores negativos de hasta un 50 %.

**Informaciones adicionales**

En la etiqueta del embalaje se encuentra el número de pedido, fecha de caducidad, temperatura de almacenamiento y número de serie. En caso de realizar consultas indicar el número de serie.

90 22 613 MUL027  
© Dräger Safety AG & Co. KGaA  
8th edition January 2005

**Dräger**

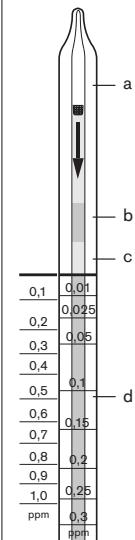

a = weiße Vorschicht,  
white prelayer,  
couche préalable  
blanche, nivel previo  
blanco

b = weiße Vorschicht,  
white prelayer,  
couche préalable  
blanche, nivel previo  
blanco

c = weiße Vorschicht,  
white prelayer,  
couche préalable  
blanche, nivel previo  
blanco

d = gelbe Anzeigeschicht, yellow indicating layer,  
couche d'indication jaune, nivel de indicación amarillo

Gebruiksaanwijzing  
**Fosforwaterstof 0,01/a**

Dräger Tube™  
81 01 611  
NEDERLANDS

**WAARSCHUWING!**  
De inhoud is toxicus en etsend, niet inslikken, contact met de huid en ogen vermijden. Voorzichtig bij het openen, er kunnen glassplinters losraken.  
Verwondinggevaar als gevolg van scherpe puntjes. Testbuisjes als gevaarlijk afval verwijderen of in de verpakking retourneren. Veilig opbergen, buiten bereik van onbevoegden.

**Toepassingsgebied**

Vaststellen van fosforwaterstof in lucht.

Meetbereik : 0,01 tot 0,3 ppm 0,1 tot 1,0 ppm

Aantal pompslagen (n) : 10

3

Duur van de meting : ca. 8 min

ca. 2,5 min

Standaardafwijking : ± 10 - 15 %

Kleuromslag : geel → rood

**Omgivingsfactoren**

Temperatuur : 2 °C tot 40 °C

Vochtigheid < 20 mg/L (gelijk aan 100 % r.L. bij 23 °C)

Luchtdruk F = 1013/daadwerk. luchtdruk (hPa)

**Reactieprincipe**

HgCl<sub>2</sub> + PH<sub>3</sub> → Hg-fosfiet + HCl

HCl + pH-indicator → rood reactieprincipe

**Voorwaarden**

Die werkingswijze van de Dräger-buisjes en de Dräger-pompen accuro, accuro 2000 en Quantimeter 1000 zijn op elkaar afgestemd. En juiste werking bij gebruik van de Dräger Tube in combinatie met andere pompen kan niet worden gegarandeerd.

**Gebruiksaanwijzing van de pomp (lektest!) lezen.**

De gemeten waarde geldt slechts voor plaats en tijdstip van de meting.

**Uitvoering van de meting en beoordeling van het meetresultaat**

- Beide punten van het buisje afbreken.
- Buisjes goed afsluitend in de pomp plaatzen. Pijl wijst naar de pomp.
- Lucht- of gasmonster door het buisje zuigen.
- Gehele lengte van de verkleuring aflezen.
- Waarde met de factor F voor de luchtdrukcorrectie vermenigvuldigen.
- Pomp na gebruik met lucht spoelen.

1 ppm PH<sub>3</sub> = 1,42 mg PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup>

1 mg PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup> = 0,71 ppm PH<sub>3</sub> (20 °C, 1013 hPa)

**Kruisgevoeligheden**

- Maximaal 6 ppm zwaveldioxide of 15 ppm chloorwaterstof storen de indicatie niet. Hogere concentraties leiden tot plusafwijkingen.
- Ammoniaak (>100 ppm) leidt tot minusafwijkingen.
- Zwavelwaterstof en arsenewaterstof worden met verschillende gevoeligheid aangegetoond.
- 30 ppm blauwzuur stort bij 3-slagenmeting niet. Bij 10-slagenmeting treden minusafwijk. tot 50 % op.

**Verdere informatie**

Op de verpakkingsbanderol worden het bestelnummer, de uiterste gebruiksdatum, de bewaar temperatuur en het serienummer aangegeven. Bij specifieke vragen dient u het serienummer op te geven.

Brugsanvisning  
**Fosfin**

Dräger®  
81 01 611  
DANSK

**BEMÆRK!**  
Prøverørets indhold har toksiske/ætsende egenskaber, må ikke indtages, udeluk hud- eller øjenkontakt. Vær forsigtig ved åbning, der kan springe glassplinter af. Fare for kvæstelser på grund af spidse med skarpe kanter. Prøverør skal bortslettes som farligt affald eller tilbageleveres i emballagen. Opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

**Anvendelsesområde**

Måling af fosfin i luft.

Måleområde : 0,01 til 0,3 ppm 0,1 til 1,0 ppm

Slagtal (n) : 10

3

Målingens varighed : ca. 8 min

ca. 2,5 min

Standardafvigelse : ± 10 - 15 %

Farveændring : gul → rød

**Omgivelsesbetingelser**

Temperatur : 2 °C til 40 °C

Fugtighed : < 20 mg/L (svarende til 100 % r.f. ved 23 °C)

Lufttryk F = 1013/faktisk lufttryk (hPa)

**Reaktionsprincip**

HgCl<sub>2</sub> + PH<sub>3</sub> → Hg-fosfid + HCl

HCl + pH-indikator → rødt reaktionsprincip

**Forudsætninger**

Funktionen for Dräger-rør og Dräger-pumper accuro, accuro 2000 og Quantimeter 1000 er afstømt efter hinanden. Hvis Dräger-rørene anvendes sammen med andre pumper, kan korrekt funktion ikke garanteres.

**Se brugsanvisningen til pumpen (tæthedstest!).**

Måleverdien gælder kun for målingens sted og tidspunkt.

**Udførelsen af målingen og analyse af måleresultatet**

- Begge spidsen af røret knækkes.
- Røret sættes tæt ind i pumpen. Pilen peger mod pumpen.
- Luft- eller gasprøven suges igennem røret.
- Aflæs hele farveændringens længde.
- Værdien ganges med faktor F for lufttryksjustering.
- Skyl pumpen med luft efter brug.

1 ppm PH<sub>3</sub> = 1,42 mg PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup>

1 mg PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup> = 0,71 ppm PH<sub>3</sub> (20 °C, 1013 hPa)

**Tværfølsomheder**

- Maksimal 6 ppm svovldioxid eller 15 ppm klorbrint forstyrre ikke visningen. Højere koncentrationer giver plusfejl.
- Ammoniak (>100 ppm) giver minusfejl.
- Sovolbrint og arsenibrint vises med forskellig følsomhed.
- 30 ppm blåsry forstyrre ikke ved 3-slag-målingen. Ved 10-slag-målingen kan der optræde minusfejl op til 50 %.

**Yderligere informationer**

På emballagens banderole findes bestillingsnummer, forbrugssdato, opbevaringstemperatur og serienummer. Oplys serienummeret ved spørgsmål.

Instruzioni per l'uso  
**Fosfina 0,01/a**

Dräger Tube™  
81 01 611  
ITALIANO

**ATTENZIONE!**  
Il contenuto delle fiale di prova ha proprietà tossiche e corrosive, non inghiottirlo, evitare qualsiasi contatto con la pelle e gli occhi. Fare attenzione nell'aprire le fiale, potrebbero saltare dei frammenti di vetro. Rischio di ferirsi con le punte spigolose. Smaltire le fiale come rifiuti pericolosi oppure rispedirle indietro nella loro confezione. Conservare le fiale al sicuro fuori dalla portata di persone non autorizzate.

**Campi d'impiego**

Determinazione della fosfina nell'aria

Campo di misurazione : 0,01 - 0,3 ppm 0,1 - 1,0 ppm

Numero pompare (n) : 10 3

Durata della misurazione : ca. 8 min ca. 2,5 min

Variazione standard : ± 10 - 15 %

Viraggio di colore : giallo → rosso

**Condizioni ambientali**

Temperatura : 2 °C - 40 °C

Umidità : < 20 mg/ (corrisp. a 100 % UR a 23 °C)

Pressione dell'aria : F = 1013/pressione dell'aria effettiva (hPa)

**Principio di reazione**

HgCl<sub>2</sub> + PH<sub>3</sub> → Hg-fosfuro + HCl

HCl + indicatore pH → principio di reazione rosso

**Requisiti**

Le fiale Dräger e le pompe Dräger accuro, accuro 2000 e Quantimeter 1000 funzionano in sintonia tra loro. Non è possibile garantire un regolare funzionamento utilizzando le fiale Dräger in combinazione con altro pompa.

**Osservare le istruzioni d'uso della pompa (test di tenuta!).**

Il valore di misurazione vale solo per il luogo ed il momento in cui è svolta la misurazione.

**Esecuzione e valutazione della misurazione**

- Romper entrambe le punte della fiala.
- Fissare bene la fiala nella pompa. La freccia è rivolta verso la pompa.
- Aspirare il campione di aria o gas attraverso la fiala.
- Rilevare la lunghezza totale del tratto del viraggio.
- Moltiplicare il valore per il fattore F per la correzione della pressione dell'aria.
- Spurgare con aria la pompa dopo averla utilizzata.

1 ppm PH<sub>3</sub> = 1,42 mg PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup>

1 mg PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup> = 0,71 ppm PH<sub>3</sub> (20 °C, 1013 hPa)

**Effetti di sensibilità trasversale**

- Max. 6 ppm di anidride solforosa o 15 ppm di acido cloridrico non interferiscono nell'indicazione. Delle concentrazioni più elevate portano a errori positivi.
- L'ammoniaca (>100 ppm) porta a errori negativi.
- L'idrogeno solforato e l'arsina vengono indicati con una sensibilità differente.
- Nella misurazione con 3 pompare 30 ppm di acido cianidrico non interferiscono affatto. Nella misurazione con 10 pompare risultano invece errori negativi in una misura massima del 50 %.

**Informazioni addizionali**

Sulla fascetta della confezione sono riportati numero d'ordinazione, data di scadenza, temperatura di conservazione e numero di serie. In caso di consultazioni indicare il numero di serie.

Инструкция по применению  
**Фосфин 0,01/a**

Dräger Tube™  
81 01 611  
РУССКИЙ

**ВНИМАНИЕ!**

Содержимое индикаторной трубки обладает токсичными/ядовитыми свойствами. Не принимать внутрь, исключать контакт с кожей и глазами. Открывайте осторожно - возможно образование осколков стекла. Существует опасность пораниться об острые края. Индикаторные трубы возвращать как опасные отходы либо возвращать поставщику в упаковке. Беречь от несанкционированного доступа.

**Область использования**

Определение содержания фосфина в воздухе.

Диапазон измерения : 0,01 - 0,3 ppm 0,1 - 1,0 ppm

Число качков (n) : 10 3

Время измерения : прибл. 8 мин прибл. 2,5 мин

Стандартное отклонение : ± 10 - 15 %

Изменение цвета : желтый → красный

**Рабочие условия окружающей среды**

Температура : 2 °C ... 40 °C

Влажность : < 20 mg/ (соотв. 100 % отн. влажн. при 23 °C)

Атмосферное давление : F = 1013/фактическое атмосферное давление (гПа)

**Принцип реакции**

HgCl<sub>2</sub> + PH<sub>3</sub> → фосфид Hg + HCl

HCl + индикатор pH → красный продукт реакции

**Условия**

Режимы функционирования индикаторных трубок Draeger и насосов Draeger accuro, accuro 2000 и Quantimeter 1000 согласованы между собой. При использовании индикаторных трубок Draeger в сочетании с другими насосами безупречное функционирование не может быть гарантировано.

**Соблюдать инструкцию по эксплуатации насоса (испытание на герметичность!).**

Измеряемое значение является действительным только для данного места и времени измерения.

**Измерение и оценка результатов**

- Отломайте оба конца трубки с помощью открывателя.
- Плотно вставьте трубку в насос. Стрелка должна указывать на насос.
- Прокачивайте пробу воздуха или газа через трубку.
- Считайте всю длину окраски.
- Умножьте значение на коэффициент F для поправки на атмосферное давление.
- После измерения прокачайте насос чистым воздухом.

1 ppm PH<sub>3</sub> = 1,42 mg PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup>

1 mg PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup> = 0,71 ppm PH<sub>3</sub> (20 °C, 1013 hPa)

**Перекрестная чувствительность**

- До 6 ppm диоксида серы или 15 ppm хлористого водорода не влияют на показания. Более высокие концентрации приводят к завышению результата.
- Аммиак (>100 ppm) приводит к занижению результата.
- Сероводород и арсин измеряются с отличающейся чувствительностью.
- 30 ppm синильной кислоты не повлияют при измерении с 3-мя качками. Однако, при измерении с 10-ю качками результаты могут занижаться до 50 %.

**Дальнейшая информация**

На бандероль упаковки нанесены номер заказа, срок годности, температура хранения и серийный номер. При запросах указывать серийный номер.

